


## INSPECTOR+ Radiation alert

Uređaj Inspector+ je namenjen za identifikaciju izvora zračenja.

(alfa,beta,gama i x-ray radijacija)

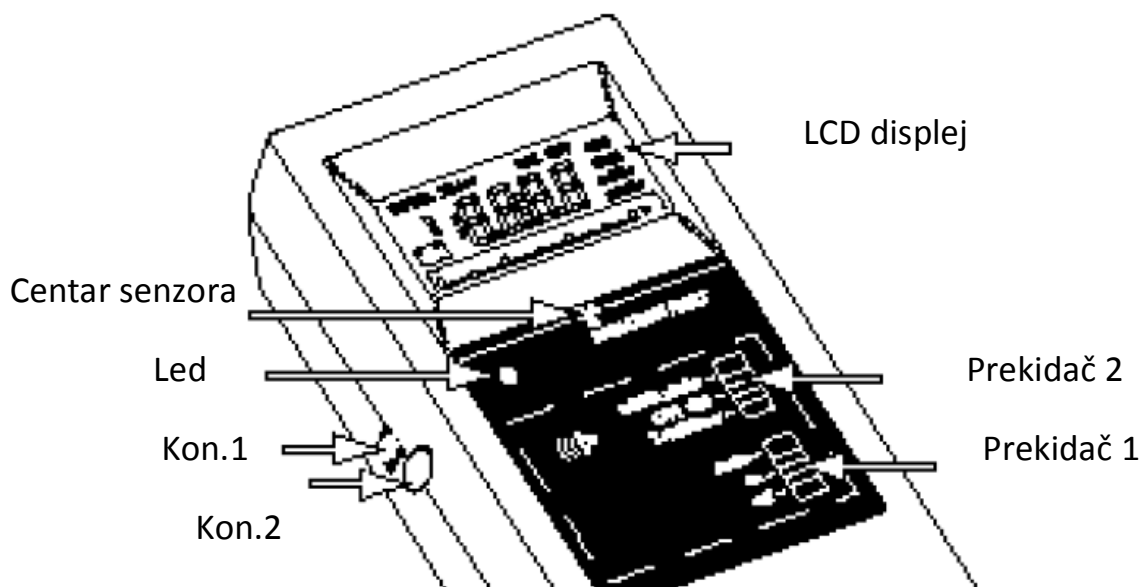

Koriscenje uređaja:

### Ukljucivanje:

Prebacite prekidač 1 (off,on,audio) na položaj ON, ukoliko zelite i zvucnu signalizaciju prebacite prekidač na položaj AUDIO.

### Vrsta merenja:

Prekidač 2 u položaju **mR/hr mikroSv/hr**

Uređaj prikazuje vrednost radijacije u jedinicama milirengena po času tj. Milisiverta po času

Na displeju je prikazana vrednost radijacije (normalna vrednost bez kontaminacije 0.005-0.030 mR/hr)

Prekidač 2 u položaju **CPM CPS** (normalna vrednost oko 30-40 CPM)

Uređaj meri broj impulsa u minuti

Prekidač 2 u položaju Total/Timer

Uređaj prikazuje ukupnu akumuliranu radijaciju u opsegu 1-9.999.000.

Kada se na ekranu pojavi ikonica Ks1000 pomnožite vrednost prikazanu na displeju sa 1000 da bi dobili ukupan nivo radijacije.

Prekidač 3 TIMER:

**OFF** –Tajmer isključen

**SET**- Podešavanje vremenskog perioda pomoću tastera + i –

Ukoliko je tajmer već uključen na displeju će biti prikazano preostalo vreme u zadatom vremenskom periodu

**ON** – Tajmer je uključen

**Konektori**

**Cal in**- Kalibracija uređaja preko pulsog generatora

**Output**- Konektor za povezivanje uređaja sa računarnom (pregled merenja, događaja i sl.)